


令和 2 年度 機器分析評価センターの組織と配置

■組織図

令和 2 年 4 月 1 日から組織改組により変更されました。

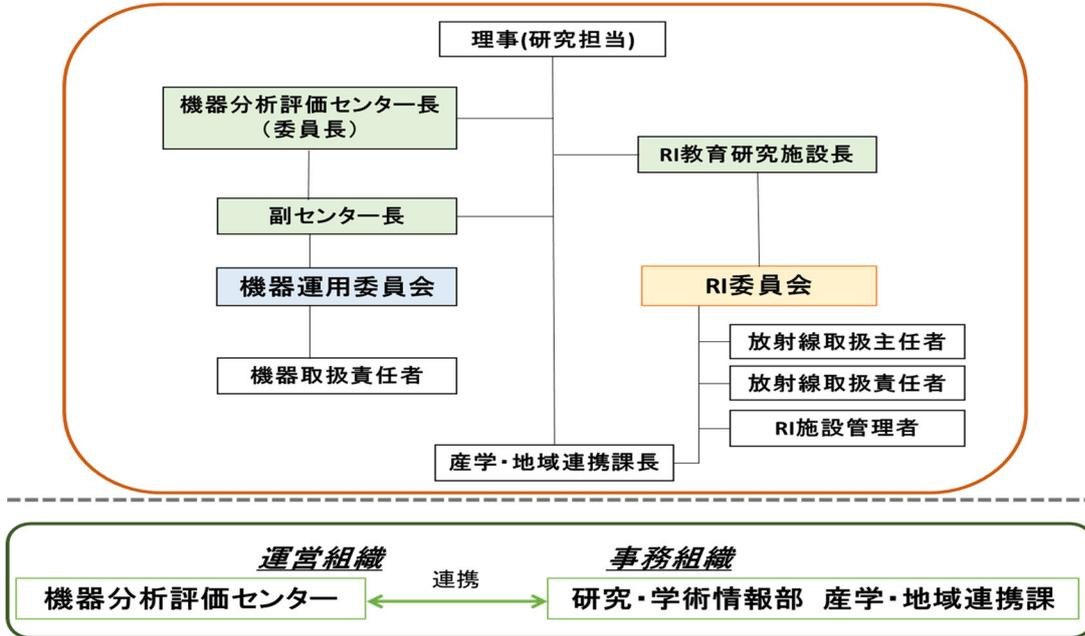

■内線電話一覧


外線からは、045-339-xxxx (x は内線番号) でおかけください。

内線	主な対応者	着信先 (部屋番号、部屋名)
4400	石原、高梨、吉原、中嶋	203 フーリエ変換赤外分光/X線回析装置室
		212-3 X線回析装置/205 試料準備室
		201 会議室
4401	谷村	202 教員研究室
4402	近藤、高梨、金田	109 透過電子顕微鏡/集束イオンビーム加工観察装置室
		111 電子線マイクロアナライザー装置室
		107 技術職員室
4403	石原	211 質量分析装置室
		207 原子吸光分光光度計/有機元素分析装置室
		208 ICP発光分光装置/蛍光X線分析装置室
4410	田中	112 走査プローブ顕微鏡/バイオ装置室
4405	石原、吉原	102 核磁気共鳴装置室
		103 走査電子顕微鏡室
		106 質量分析装置室
4406	香川	108 事務室 (電話、Fax)
4408	近藤、石原、高梨、吉原、金田、中嶋	107 技術職員室 (電話、Fax)
4410	田中	RI-112 RI教育研究施設 管理室

※2021年2月現在、新型コロナウイルス感染防止対策のため居室を分散しています。

■館内図

機器分析評価センター

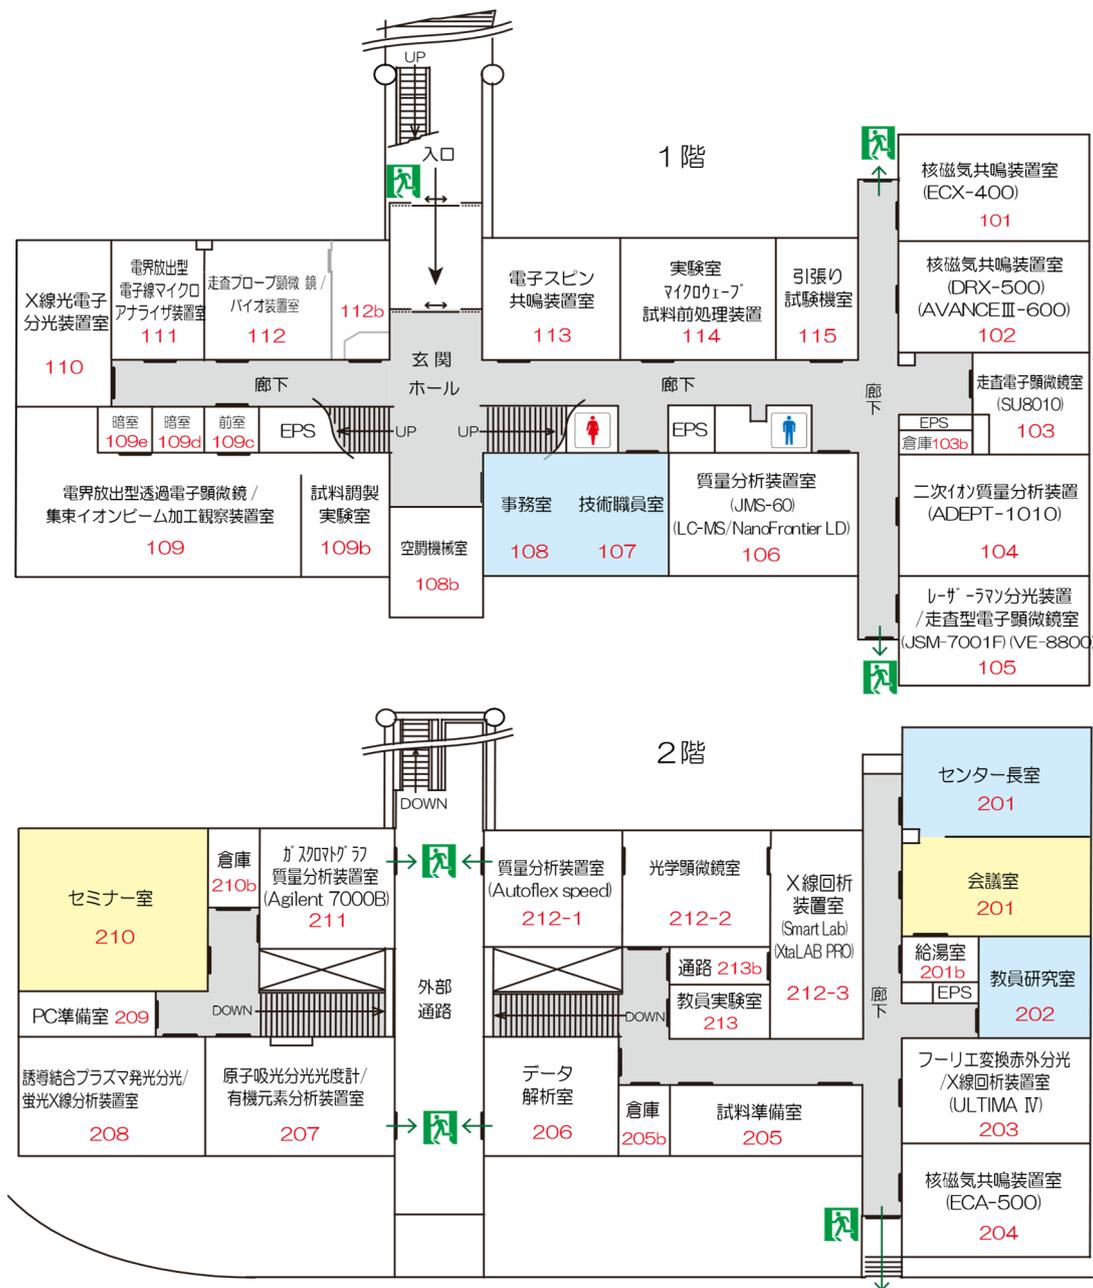

RI 教育研究施設

